

Test Auswertung

Cardio


E+S GmbH

Regerstraße 2
22761 Hamburg
Tel. 040-890 61 63
Fax: 040-890 61 649
Ansprechpartner:
Steffen Eichstaedt
Stephan Schüle




Name, Vorname	Muster, Martin	Telefon	040 - 00 00 00
Geburtsdatum	13.06.1945	Krankenkasse	BKK Muster
ID	1	Tätigkeit	Mustermacher
Straße	Musterstraße 8	Arzt	Dr. Mustermann
PLZ / Wohnort	22222 Musterstadt	Therapeut	Martina Musterfrau
Bemerkungen	Keine		

Martin Muster Analyse vom 07.01.2003 15:12 , Gerät: Cycle 1200 c

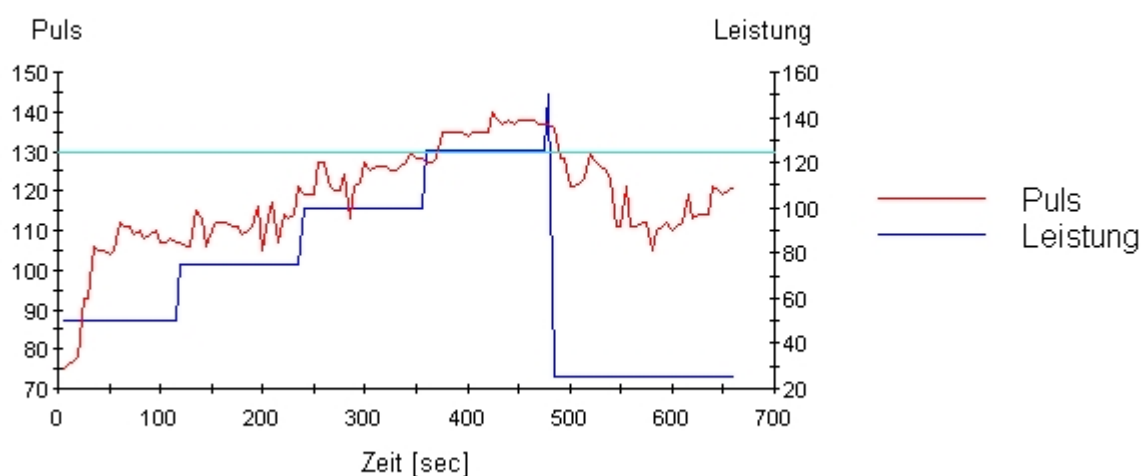

Martin Muster Analyse vom 19.03.2003 16:44 , Gerät: Cycle 1200 c

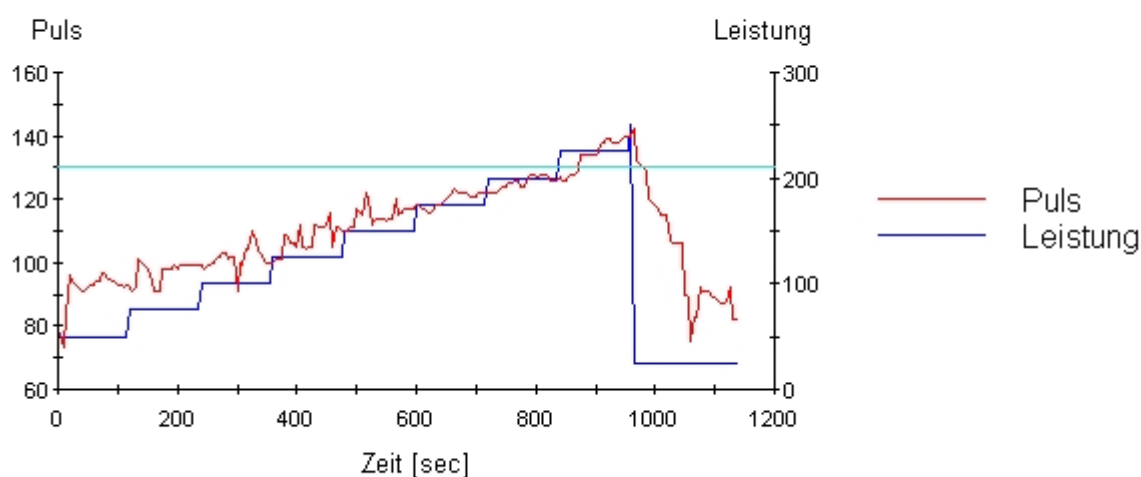

Test Auswertung**E+S GmbH**

Regerstraße 2
 22761 Hamburg
 Tel. 040-890 61 63
 Fax: 040-890 61 649
 Ansprechpartner:
 Steffen Eichstaedt
 Stephan Schülein



Name, Vorname *Muster, Martin*
ID *1*

Datum	Analyse vom 07.01.2003 15:12	Analyse vom 19.03.2003 16:44	-
Leistung in Watt/max. Geschwindigkeit	150 Watt	250 Watt	-
max. Puls	140	140	-
Zeit in Min.	11:00	19:00	-
PWC130	1,34	2,42	-
PWC150	0	0	-
PWC170	0	0	-
Trainingszustand	Untrainiert	Trainiert	-
Ruhepuls	75	78	-
Pulsdifferenz nach 3 Minuten	15 Schwach	59 Gut	-
RPE (subj. Anstrengungsempfinden)	15	13	-
Puls nach 1 Min.	111	107	-
Puls nach 2 Min.	111	91	-
Puls nach 3 Min.	120	82	-